



DH-Pro<sup>®</sup>

論より証拠 論より結果

Concept

## 自分を大切するということ。

あなたにとって、“かけがえのないもの”は何でしょうか。  
家族と過ごす時間、共に歩む仲間、叶えたい夢…。  
そのすべては、あなたの人生を彩る大切な存在です。

けれど、そのすべてを大切にしたいために、  
いちばんに向き合うべきは“あなた自身”。

限りある人生のなかで、本当に大切なものを、  
大切にできる人であり続けたい。

そんなあなたにとっての最高の選択肢。


それが『水素』

それが『DH-Pro®』





# 水素は「飲む」から「吸う」時代へ

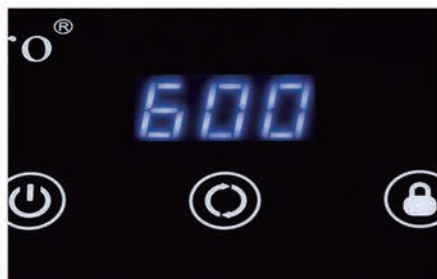

600ml/分・300ml/分・100ml/分  
水素発生量を3段階から調節可能



2人同時吸入に対応  
専用アダプター、チューブで最大8人吸入可



目からも水素吸入可能  
2つの水素出口で目と鼻から同時吸入可能



ナイトモード搭載  
30dB低騒音 / LED消灯 / 最大8時間稼働



洗練されたデザイン性  
高耐久で1万時間に1回のメンテナンス

| 100ml/分 モード<br>1時間稼働時       | 300ml/分 モード<br>1時間稼働時 | 600ml/分 モード<br>1時間稼働時 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 約10ml<br>消費                 | 約25ml<br>消費           | 約50ml<br>消費           |
| 電気代 600・300ml/分モード 30分 1〜2円 |                       |                       |

優れたコストパフォーマンスを実現

## 安心してご使用いただくための取り組み

### 第三者機関による分析結果報告書を取得済み

第三者機関『一般社団法人 生体ガス療法評価機関』による水素ガス濃度測定結果

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 10.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 25.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 50.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 項目     | 測定値   | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 100.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9  | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1  | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 10.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 25.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 50.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 項目     | 測定値   | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 100.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9  | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1  | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 10.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 25.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| 項目     | 測定値  | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 50.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9 | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1 | ppm |

分析結果報告書

報告書番号: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関 報告書番号: 123456789

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 項目     | 測定値   | 単位  |
| 水素ガス濃度 | 100.0 | ppm |
| 酸素ガス濃度 | 20.9  | ppm |
| 窒素ガス濃度 | 79.1  | ppm |




### DH-Pro® 完全監修

医師・医学博士

久保 伸夫

日本耳鼻咽喉科学会専門医 / 日本アレルギー学会専門医代議員  
日本気管食道科学会認定医 / カンボジア外国医師免許第20号  
国際顔面形成学会日本支部代表  
日本アレルギー学会専門医代議員

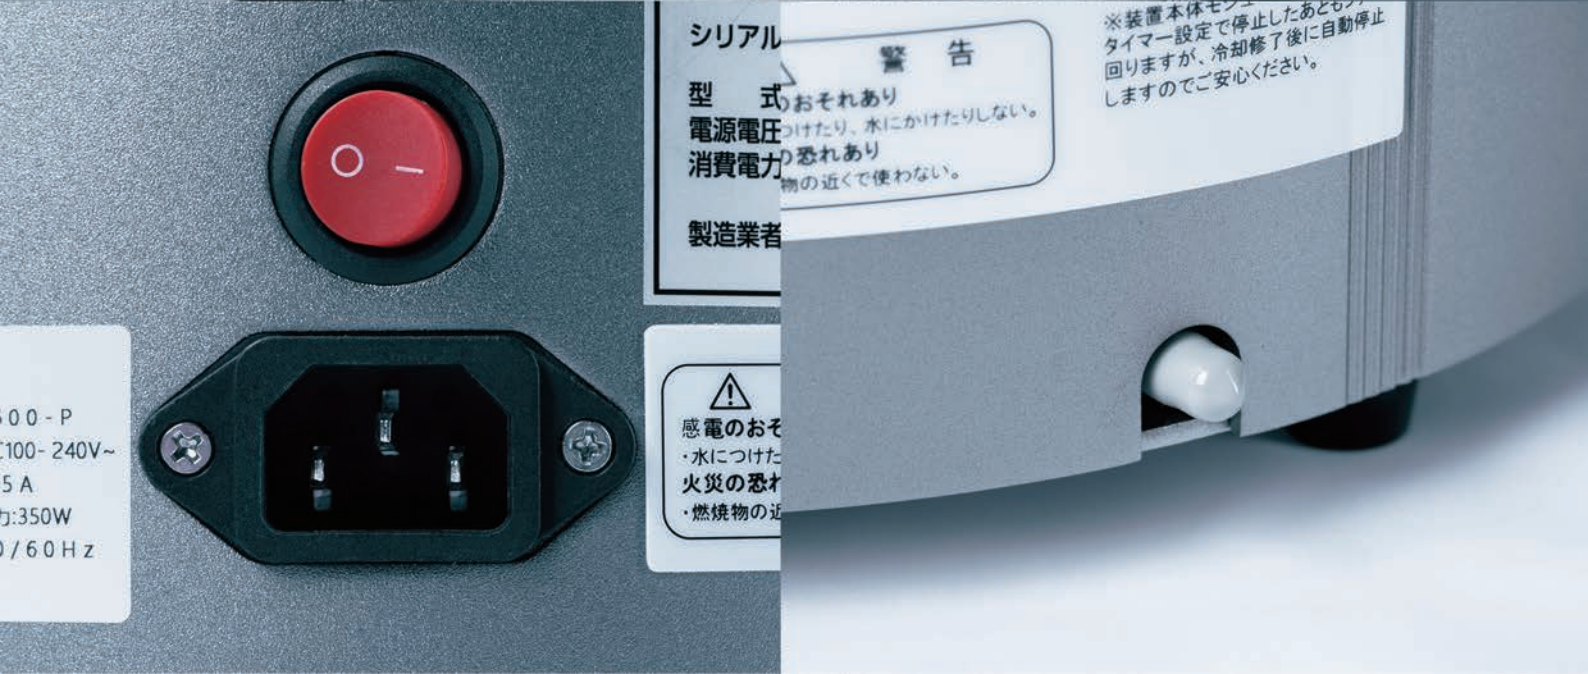

セット内容



加熱式ネブライザDH-Pro® 本体



Y字型チューブ 2本



排水用チューブ(2m) 1本



注水口キャップ 1個



注水用ロート 1個



吸入チューブ+チューブ付チャンバー 3セット



ドクター水素メガネ 2個



精製水 3本



取り扱い説明書 1冊



登録カード 1枚



電源ケーブル 1本



排水口キャップ(予備) 1個

製品仕様

|        |                  |          |                                 |
|--------|------------------|----------|---------------------------------|
| 項 目    | 仕様規格             | 水素濃度     | 99.9%                           |
| 商品名    | 加熱式ネブライザ DH-Pro® | 生成ガス最大圧力 | 0.5Mpa                          |
| 型 式    | DH600-P          | 電解方式     | 加熱式ネブライザ                        |
| JANコード | 458994322        | 定格電圧     | AC100V~AC240V 50/60Hz           |
| 水素生成量  | 最大600ml/min      | 製品寸法     | W265 x 0245mm x H380mm /重量8.3kg |
| 酸素生成量  | 最大300ml/min      | 使用する水    | 精製水または蒸留水                       |
| 定格消費電力 | 350W             | 医療機器許可番号 | 27B2X90003000007                |

600ml/minを30分使用時の消費電力は260wで電気代は約2円、300ml/minを30分使用時の消費電力は70wで電気代は約1円、ナイトモードを6時間使用時の消費電力は300wで電気代は約9.3円（あくまでも目安としてお考えください。）